


DESCRIZIONE TECNICA  
E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



POLTRONA ELETTRICA/ELETTROMEDICALE  
CON PARTI MOBILI E SOLLEVATORE

MODELLO **Firenze**

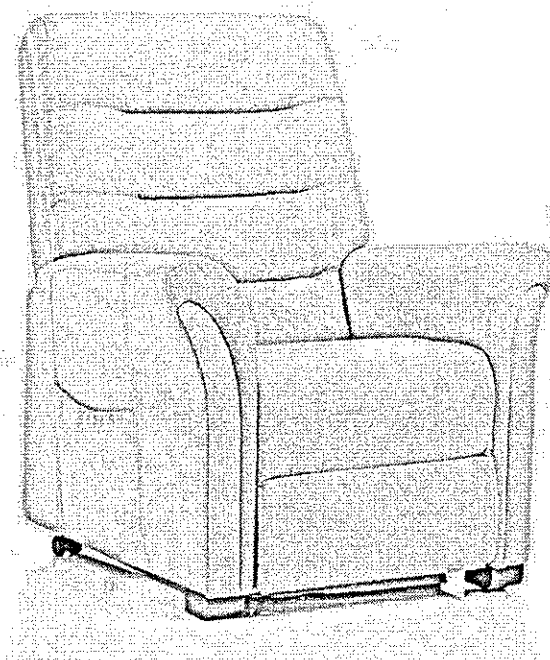

**OBBLIGATORIO**


LEGGERE QUESTO DOCUMENTO PRIMA DELL'INSTALLAZIONE E DELL'USO DELLA  
POLTRONA PER IL SUO USO SICURO E APPROPRIATO.

*DESCRIZIONE TECNICA rev. 5 del 11.02.2022*

## 1. Caratteristiche fisiche e prestazionali significative

Di seguito sono riportate le caratteristiche del modello.

### 1.1. Dimensioni, peso poltrona e peso massimo utente

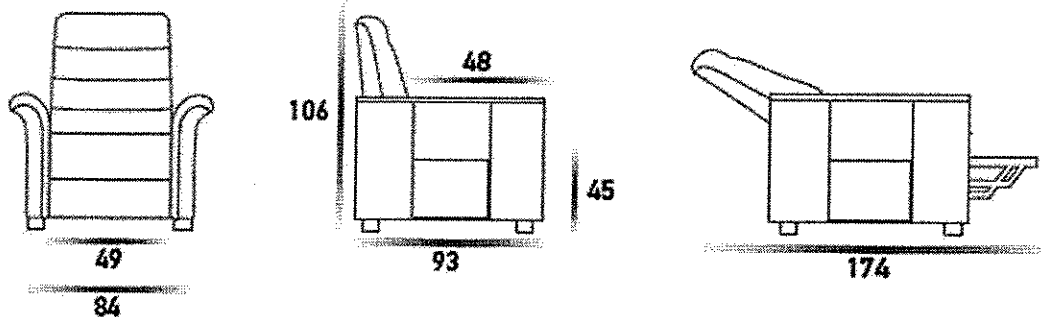

Peso poltrona 52 kg

Peso max utente 110 kg

Peso max totale 150 kg

### 1.2. Dati meccanici

|  |  |
|--|--|
| Materiale Struttura e meccanismo   | In acciaio verniciato a polvere          |
| Materiale Struttura fusto poltrona   | legno                                    |
| Ruote posteriori di serie (diametro)   | 35 mm pivotanti                          |
| Ruote roller-system (diametro)   | 48 mm (ant.), 38 mm (post.)<br>pivotanti |
| Appoggi anteriori del telaio   | in gomma 40mm x 15mm                     |
| Piedi poltrona anteriori   | Legno $\phi$ 40 mm                       |
| Numero attuatori lineari   | 2 indipendenti                           |
| Angolo seduta in posizione normale (rispetto all'orizzontale)  | -6°                                      |
| Altezza ottenibile in sollevamento con la seduta in orizzontale  | 8 cm davanti, 16.5 cm dietro             |
| Angolo seduta in posizione lift (rispetto all'orizzontale)   | +17°                                     |
| Angolo minimo schienale (rispetto alla seduta)   | 80°                                      |
| Angolo massimo schienale (rispetto alla seduta)  | 108°, 132° (cardiorelax)                 |
| Angolo minimo pediera rispetto alla seduta (chiusa)  | 96°                                      |
| Angolo massimo pediera rispetto alla seduta (estesa)   | 0°                                       |
| Angolo massimo pediera rispetto all'orizzontale (cardiorelax)  | -9°                                      |
| tempo impiegato dallo schienale per max escursione;  | circa 17s                                |
| tempo impiegato dalla pediera per max escursione;  | circa 13s                                |
| tempo impiegato dalla poltrona per alzarsi con la seduta orizzontale   | circa 5s                                 |
| tempo impiegato dalla poltrona per alzarsi e inclinarsi in avanti alla sua massima escursione in posizione lift: | circa 20s                                |

### 1.3. Dati elettrici

|   |          |
|---|----------|
| Tensione di ingresso                      | 230 V AC |
| Frequenza                                 | 50/60 Hz |
| Tensione in uscita dall'alimentatore      | 29V CC   |
| Corrente nominale                         | 1.3A     |
| Lunghezza cavo di alimentazione elettrica | 3.1m     |
| Potenza nominale:                         | 1900 VA  |

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
|                                   | Unità di alimentazione interna  | 38W  |
|                                   | Classe di isolamento  | classe II (protezione dai contatti diretti ed indiretti)       |
|                                   | Classe di protezione alimentatore   | IP20   |
|                                   | Ambiente di installazione   | Interno Residenziale Domestico                                 |
|                                   | Tensione di alimentazione e Potenza attuatori   | 29v DC, 75W  |
|                                   | Tempo di operatività continuo massimo di ognuno degli attuatori elettrici / tempo di raffreddamento minimo                                    | 2 min. ON / 18 min. OFF  |
|                                   | Pulsantiera di comando a filo   | 4 tasti  |
| <b>1.4. Parti applicate</b>       | Classificazione parti applicate ( <i>seduta, schienale, pediera, braccioli, maniglione, pedale meccanismo di sollevamento roller-system</i> ) | tipo B (grado di protezione dai contatti diretti ed indiretti) |
| <b>1.5. Rivestimenti</b>          | Tessuto idrorepellente e antimacchia  | Vedi specifica   |
|                                   | Tessuto anallergico   |  |
|                                   | Valutazione biologica   | EN ISO 10993   |
| <b>1.6. imbottitura</b>           | materiale   | poliuretano espanso indeformabile con falda in dacron          |
|                                   | Schienale   | 23 Kg/m <sup>3</sup>   |
|                                   | Pediera   | 21 Kg/m <sup>3</sup>   |
|                                   | Seduta  | 35 Kg/m <sup>3</sup>   |
|                                   | Braccioli   | 30 Kg/m <sup>3</sup>   |
| <b>1.7. Dati elettromagnetici</b> | EMISSIONI RF (CISPR 11)   | GRUPPO 1, CLASSE B   |
| <b>1.8. Dati ambientali</b>       | Condizioni d'esercizio  |  |
|                                   | <i>Temperatura</i>  | 10°C÷40°C  |
|                                   | <i>Umidità</i>  | 30%÷75%  |
|                                   | <i>Pressione atmosferica</i>  | 795hPa÷1060hPa   |
|                                   | <i>Altitudine</i>   | 2000m s.l.m.m.   |
|                                   | Condizioni Immagazzinamento   |  |
|                                   | <i>Temperatura</i>  | -10°C÷50°C   |
|                                   | <i>Umidità</i>  | 20%÷90% (anti-condensa)  |
|                                   | <i>Pressione atmosferica</i>  | 795hPa ÷1060hPa  |
|                                   | Condizioni trasporto  |  |
|                                   | <i>Temperatura</i>  | -10°C÷50°C   |
|                                   | <i>Umidità</i>  | 20%÷90% (anti-condensa)  |
|                                   | <i>Pressione atmosferica</i>  | 795hPa ÷1060hPa  |

## 2. Varianti e accessori


Di seguito sono riportate le principali varianti dovute alle meccaniche e accessori delle poltrone. Nel documento descrizione tecnica (scaricabile dal sito internet di Spazio Relax S.P.A. inquadrando con lo smartphone il QR code riportato in seconda pagina del manuale), sono riportati varianti e accessori specifici del modello acquistato.

### 2.1 Meccanica con un motore



Schienale e pediera si muovono in modo sincronizzato. Il movimento della pediera è anticipato, e si solleva prima dell'abbassamento dello schienale, consentendo così la posizione comoda per la tv. Questo meccanismo ha il movimento alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione eretta alle persone con difficoltà motoria. Nella prima fase dell'alzata, la poltrona può assumere la posizione sollevata di 10 cm con la seduta orizzontale.

## 2.2 Meccanica con due motori



I due attuatori lineari in dotazione sono destinati all'azionamento indipendente dello schienale l'uno, e della pediera l'altro, ambedue dotati di fine corsa di andata e ritorno con spegnimento di sicurezza integrato. All'attuatore della pediera è affidata la movimentazione lift, che permette alla poltrona di alzarsi e inclinarsi in avanti con l'utente sopra. Nella prima fase dell'alzata, la poltrona può assumere la posizione sollevata di 10 cm con la seduta orizzontale.

## 2.3 Meccanica con due motori cardiorelax



La meccanica cardiorelax è una meccanica a due motori che oltre alle sue funzioni, permette all'utente di assumere una posizione anti-shock, ovvero la posizione supina e inclinata obliquamente in modo che la testa si trovi più in basso dei piedi.

## 2.4 Roller System



Il Roller System è un accessorio che serve a rendere la poltrona mobile su rotelle. Azionato mediante una leva a pedale posta nella parte posteriore della poltrona la solleva su un telaio dotato di 4 ruote indipendenti.

Il roller system serve a permettere un agevole spostamento della poltrona da una stanza all'altra su pavimenti in piano stabili e non cedevoli, privi di ostacoli. Grazie alle ruote pivotanti, permette sia spostamenti lineari che la rotazione totale della poltrona.

Il roller system è progettato e costruito per essere utilizzato con la poltrona scarica. Non deve essere utilizzato con l'utente che occupa la poltrona.

## 2.5 Maniglione



Pratico e solido maniglione in acciaio, utile per muovere e spostare la poltrona.

Predisposto sulla parte posteriore dello schienale serve per spingere e far ruotare la poltrona dotata di Roller system, evitando di maneggiare la poltrona dal tessuto di rivestimento.

## 2.6 Braccioli estraibili



Con la versione "BRACCIOLO ESTRAIBILE" è possibile utilizzare la poltrona sotto un normale tavolo da pranzo o in alternativa inserire all'occorrenza l'accessorio tavolino.

## 2.7 Tavolino



Con la versione "BRACCIOLO ESTRAIBILE" è possibile utilizzare la poltrona sotto un normale tavolo da pranzo o in alternativa inserire all'occorrenza l'accessorio tavolino.

## 2.8 Fodere copri poltrona



Rivestimenti ausiliari, removibili e lavabili, che proteggono la poltrona nelle parti di maggiore usura.

Le fodere di protezione sono state ideate per garantire la salvaguardia dall'usura e dallo sporco delle zone maggiormente soggette della poltrona.

E' prevista una copertura per lo schienale, una per la seduta ed una per i braccioli che si conformano ai componenti rendendone impercettibile la loro presenza.

**3. COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA****3.1 EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE - LINEE GUIDA E DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE**

Il dispositivo è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito.

Il cliente o l'utente del dispositivo deve assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.

| Prova emissioni   | Conformità   | Ambiente elettromagnetico - guida   |
|---|--|---|
| Emissione RF (energia a radiofrequenza) irradiata<br>CISPR 11 | Gruppo 1   | Il dispositivo utilizza energia a radiofrequenza solo per la sua funzione interna.<br><br>La poltrona è adatta all'uso in qualunque edificio residenziale e quelli direttamente collegati alla rete di alimentazione pubblica a bassa tensione che alimenta gli ambienti domestici.<br><br>Pertanto, le sue emissioni sono molto basse e non possono causare alcuna interferenza nelle apparecchiature elettroniche vicine. |
| Emissione RF (energia a radiofrequenza) irradiata<br>CISPR 11 | Classe B   |   |
| Emissioni armoniche<br>IEC 61000-3-2                          | Tutti i valori sono risultati inferiori ai limiti stabiliti. l'emissione soddisfa le specifiche della norma applicabile  |   |
| Fluttuazioni di tensione/flicker<br>IEC 61000-3-3             | Tutti i valori sono risultati inferiori ai limiti stabiliti. La massima variazione relativa della tensione ai morsetti dell'EUT soddisfa le specifiche della norma applicabile |   |


**3.2 IMMUNITÀ ELETTROMAGNETICA - LINEE GUIDA E DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE**

Il dispositivo è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito.

Il cliente o l'utente del dispositivo deve assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.

| Test immunità                                 | Livello di test IEC 60601   | Livello di conformità                   | Ambiente elettromagnetico – Linee guida   |
|---|---|---|---|
| Scarica elettrostatica (ESD)<br>IEC 61000-4-2 | ±6 kV a contatto<br>±8 kV in aria   | ±8 kV a contatto<br>±15 kV in aria      | I pavimenti devono essere in legno, calcestruzzo o mattonelle di ceramica.<br>Se i pavimenti sono rivestiti con materiale sintetico, l'umidità relativa dovrà essere almeno pari al 30% |
| Transitori veloci/burst<br>IEC 61000-4-4      | ±2 kV per le reti di corrente elettrica<br>±1 kV per le reti di ingresso/uscita | ±2 kV per le reti di corrente elettrica |   |
| Sovratensione<br>IEC 61000-4-5                | modalità differenziale<br>±1 kV   | Funzionamento durante e dopo la         |   |

| Test immunità   | Livello di test IEC 60601  | Livello di conformità   | Ambiente elettromagnetico –<br>Linee guida  |
|---|--|---|---|
|   | ±2 kV modo comune  | prova regolare e senza degrado o perdita delle prestazioni ed ha rispettato il criterio di suscettibilità applicabile                                 |   |
| <b>Cali di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione sulle reti di ingresso di alimentazione 61000-4-11</b> | <5% UT (calo >95% in UT) per 0,5 ciclo                                 | Funziona con buchi di tensione del 30 e 60% e si spegne con buchi del 100%. Ha rispettato il criterio di suscettibilità applicabile                   |   |
|   | 40% UT (calo 60% in UT) per 5 cicli                                    |   |   |
|   | 70% UT (calo 30% in UT) per 25 cicli                                   |   |   |
|   | <5% Ut (calo >95% in UT) per 5 sec.                                    |   |   |
| <b>Frequenza di alimentazione (campo magnetico) 50/60 Hz IEC 61000-4-8</b>  | 3 A/m  | Funzionamento durante e dopo la prova regolare e senza degrado o perdita delle prestazioni ed ha rispettato il criterio di suscettibilità applicabile | I campi magnetici a frequenza di potenza devono trovarsi a livelli non superiori rispetto a quelli di postazioni ubicate in tipiche applicazioni industriali pesanti, centrali elettriche e sale di comando di sottostazioni ad alta tensione.  |
| <b>Nota: UT è la corrente alternata di rete prima dell'applicazione del livello di prova.</b>                           |  |   |   |
| <b>RF condotta IEC 61000-4-6</b>  | 3 Vrms da 150 kHz a 80 MHz al di fuori delle bande ISM <sup>(a)</sup>  | Funzionamento durante e dopo la prova regolare e senza degrado o perdita delle prestazioni ed ha rispettato il criterio di suscettibilità applicabile | Non utilizzare attrezzature portatili e mobili di comunicazione a radiofrequenza in prossimità di qualunque parte della poltrona, compresi i cavi, se non alla distanza consigliata, calcolata a partire dall'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore.<br>Distanza di separazione<br>Raccomandata:<br>d = 1,2 √P da 80 MHz a 800 MHz<br>d = 2,3√P da 800 MHz a 2,5 GHz dove P è l'intervallo di potenza di uscita massima del trasmettitore in watt (W) secondo i dati del fabbricante del trasmettitore e d è la distanza consigliata in metri <sup>(b)</sup><br>Le intensità di campo dei trasmettitori fissi a radiofrequenza, come determinato da un'indagine in siti elettromagnetici <sup>(c)</sup> , dovrebbero essere inferiori al livello di conformità in ogni |
|   | 10 Vrms da 150 kHz a 80 MHz all'interno delle bande ISM <sup>(a)</sup> |   |   |
| <b>RF irradiata IEC 61000-4-3</b>   | 10 V/m da 80 MHz a 2,5 GHz   | Funzionamento durante e dopo la prova regolare e senza degrado o perdita delle prestazioni ed ha rispettato il criterio di suscettibilità applicabile |   |

| Test immunità | Livello di test IEC 60601 | Livello di conformità | Ambiente elettromagnetico –<br>Linee guida  |
|---------------|---------------------------|-----------------------|---|
|               |                           |                       | gamma di frequenza <sup>(d)</sup> .<br>In prossimità degli apparecchi<br>contrassegnati da questo<br>simbolo<br><br>possono verificarsi delle<br>interferenze. |

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, si applica l'intervallo di frequenza superiore.

NOTA 2: Queste linee guida possono non valere in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione da strutture, oggetti e persone.

<sup>(a)</sup> Le bande ISM (industriale, scientifica e medica) tra 150 kHz e 80 MHz sono da 6,765 MHz a 6,795 MHz; da 13,553 MHz a 13,567 MHz; da 26,957 MHz a 27,283 MHz; e da 40,66 a 40,70 MHz.

<sup>(b)</sup> I livelli di conformità nelle bande ISM tra 150 kHz e 80 MHz e tra 80 MHz e 2,5 GHz sono predisposti per diminuire le possibilità di interferenza nel caso in cui gli apparecchi di comunicazione portatili e mobili vengano avvicinati inavvertitamente all'area in cui si trova il paziente. Per questa ragione, nel calcolo della distanza di separazione consigliata per i trasmettitori che operano in queste gamme di frequenza si utilizza un fattore extra di 10/3.

<sup>(c)</sup> Non è possibile prevedere con precisione a livello teorico le intensità di campo dei trasmettitori fissi, come le stazioni base per i radiotelefoni (cellulari/cordless) e le radiomobili, le radio amatoriali, le radiotrasmissioni AM e FM e TV.

Per misurare l'ambiente elettromagnetico derivante dai trasmettitori RF fissi, è necessario considerare la possibilità di condurre una specifica ispezione sul posto. Se la potenza dei campi misurata nella sede in cui viene usata la poltrona supera il livello di conformità RF specifico di cui sopra, sarà necessario tenere sotto osservazione la poltrona per verificarne il corretto funzionamento. Se si rileva un difetto di funzionamento, potrebbe essere necessario adottare misure supplementari come il riorientamento o il riposizionamento della poltrona.

<sup>(d)</sup> Oltre l'intervallo di frequenze tra 150 kHz e 80 MHz, le potenze dei campi devono essere inferiori a 1 V/m.

### 3.3 Distanze di separazione raccomandate:

Il dispositivo è adatto all'uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF irradiati sono controllati. Il cliente o l'utente del dispositivo può aiutare a evitare le interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra l'apparecchiatura trasmittente a RF mobile e portatile e il dispositivo come raccomandato sotto, in accordo alla massima Potenza di uscita del trasmettitore.

| Massima potenza di targa<br>del trasmettitore (W) | Distanza di separazione secondo la frequenza del trasmettitore (m) |  |   |
|---|--|--|---|
|   | Da 150 kHz a 80MHz<br>$d = 1,2\sqrt{P}$                            | Da 80 MHz a 800 MHz<br>$d = 1,2\sqrt{P}$ | Da 800 MHz a 2,7 GHz<br>$d = 2,3\sqrt{P}$ |
| 0,01  | 0,12   | 0,12                                     | 0,23                                      |
| 0,1   | 0,38   | 0,38                                     | 0,73                                      |
| 1   | 1,2  | 1,2                                      | 2,3                                       |
| 10  | 3,8  | 3,8                                      | 7,3                                       |
| 100   | 12   | 12                                       | 23  |

Per trasmettitori la cui massima Potenza di targa non è mostrata nella lista sopra, la distanza di separazione "d" raccomandata in metri (m) può essere calcolata usando l'equazione alla frequenza del trasmettitore, dove P è la massima potenza di uscita di targa del trasmettitore in watt (W), secondo il costruttore del trasmettitore.

## 5. Dichiarazione di conformità poltrona

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

(ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 MAGGIO 2006)

Spazio Relax S.p.A.

**denominazione commerciale registrata o marchio registrato****spazi@relax****sede legale**

Via Giuseppe Posca, 33 70124 BARI (BA)

P. I.V.A. 01146400773

**sede amministrativa**

Via dell'Agricoltura, Zona Paip 2 MT

Tel. + 39 0835 256477

[info@spaziorelaxitalia.com](mailto:info@spaziorelaxitalia.com)

Attesta che la presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la propria responsabilità di fabbricante e riguarda esclusivamente la POLTRONA DOMESTICA CON PARTI MOBILI MOTORIZZATE ELETTRICAMENTE modello:

**identificativo**


GS1 8058333640730

**nome del prodotto e denominazione commerciale**

FIRENZE LIFT 2 MOTORI DM

**codice del prodotto**

FIRENZE.L2M

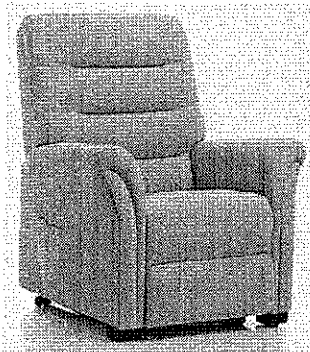**Fotografia del prodotto**



## DICHIARA

Che la **POLTRONA DOMESTICA CON PARTI MOBILI MOTORIZZATE ELETTRICAMENTE** oggetto della presente dichiarazione è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive comunitarie pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>DIRETTIVA 2006/42/CE</b> | <i>del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE</i>  |
| <b>DIRETTIVA 2014/35/UE</b> | <i>del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione</i> |
| <b>DIRETTIVA 2014/30/UE</b> | <i>del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità</i>   |
| <b>DIRETTIVA 2002/95/CE</b> | <i>del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>  |
| <b>DIRETTIVA 2012/19/UE</b> | <i>del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)</i>  |

E che gli standard tecnici utilizzati per dichiarare la conformità sono:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>EN ISO 12100:2010</b>    | <i>Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction</i>   |
| <b>IEC 60335-1:2020</b>     | <i>Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements</i>  |
| <b>IEC 60335-2-116:2019</b> | <i>Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-116: Particular requirements for furniture with electrically motorized parts</i> |
| <b>ISO 7000:2019</b>        | <i>Graphical symbols for use on equipment — Registered symbols</i>  |
| <b>ISO 7010:2019</b>        | <i>Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs</i>  |
| <b>EN 13759:2012</b>        | <i>Furniture - Operating mechanisms for seating and sofa-beds - Test methods</i>  |

Matera, 25 giugno 2021

**l'Amministratore Unico**

*Francesco Tamburrino*